
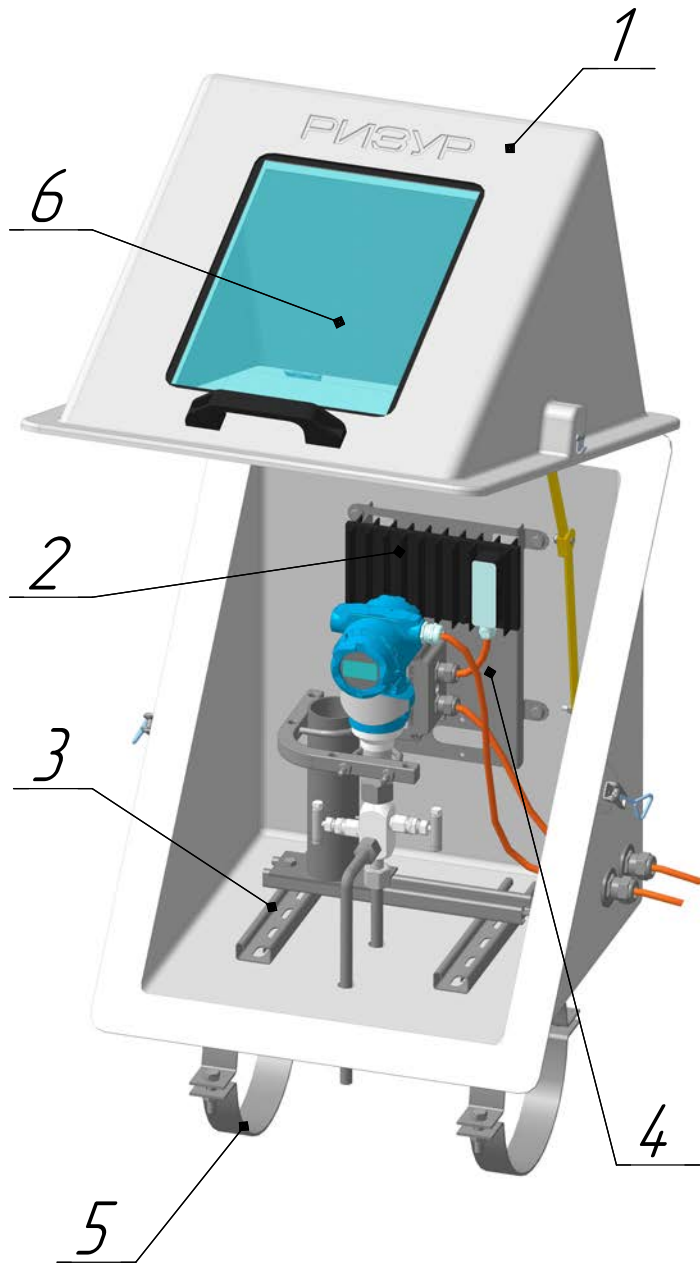
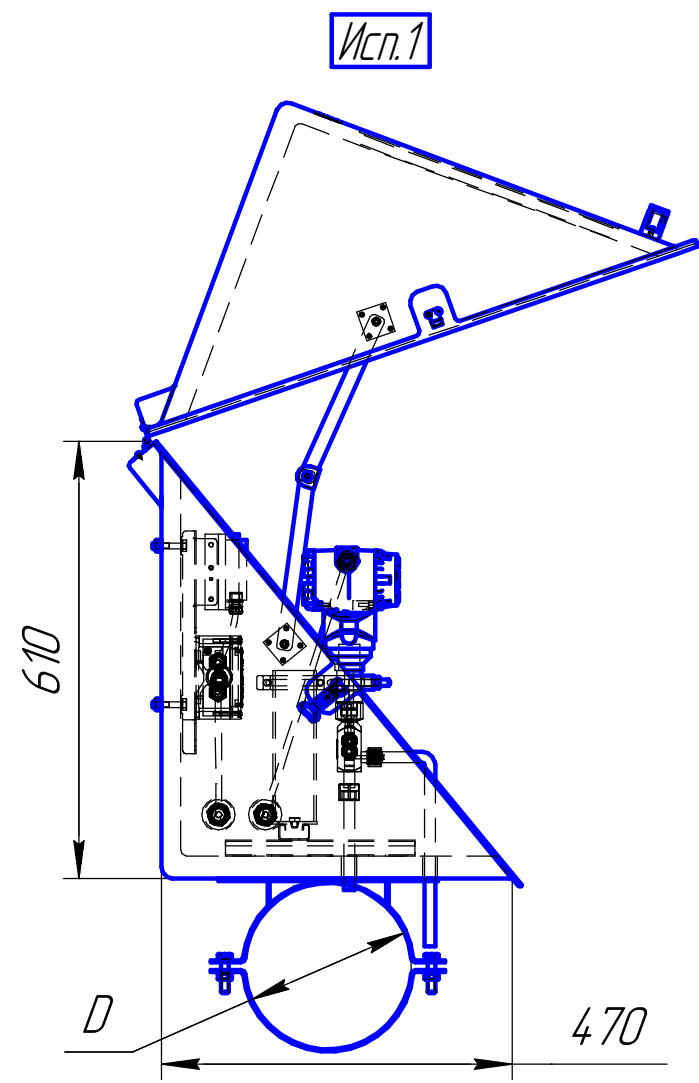


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

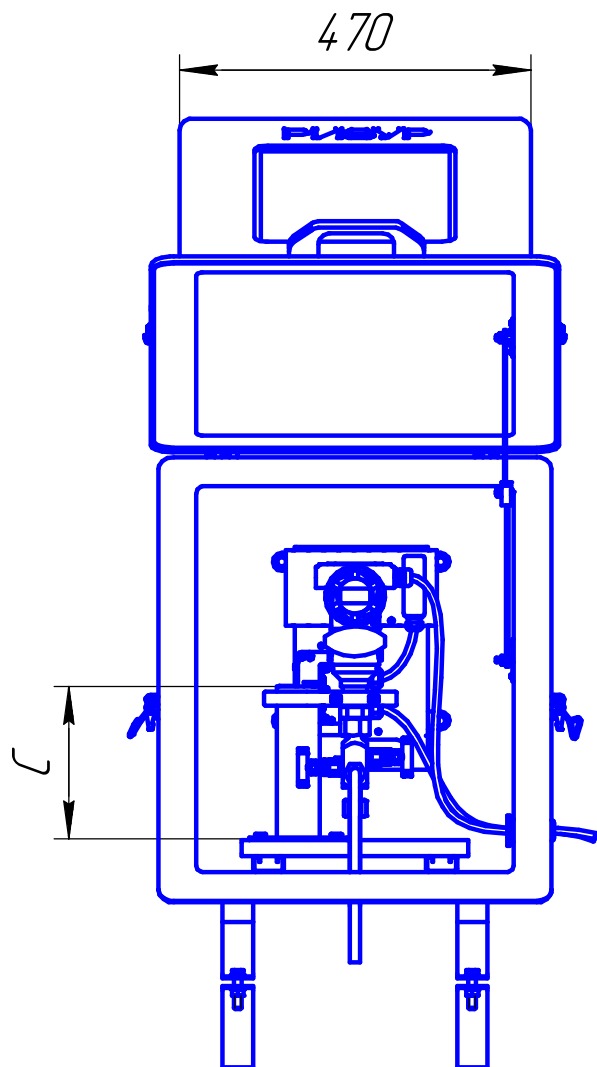

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Шкаф защитный утеплённый стеклопластиковый РизурБокс-С-7	1	
2	Обогреватель взрывозащищённый с терморегулятором	1	
3	АТР с комплектом шин	1	
4	Монтажная панель	1	
5	Крепление на трубу	2	
д/п	КМЧ (Болты, шайбы, гайки)	1	
д/п	Шпилька заземления в сборе	1	

Заполняется заказчиком:			
Поз.	Наименование	Размер(наличие)	Вариант исполнения
3	АТР	С=	Исп.1 ☐
5	Хомут	D=	
6	Окно	☐	

Тип обогрева				Дополнительное оснащение			
FT	ST	SR	AR	Удалённый контроль обогрева			Доп.
				RS485	4-20мА	Реле Н/О-Н/З	теплоизоляция
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Трубный ввод		Кабельный ввод			
φ трубки	Кол.	Внеш. φ каб.	Внутр. φ каб. (брон. каб.)	Марка мет. рукава	Кол.

*По умолчанию отверстия под кабельные и трубные вводы сверлятся заказчиком при монтаже

	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Заполнено			
Организация			

Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РизурБокс С-7 для Элемер100 с двухвентильным блоком	Лит.	Масса	Масштаб
						-	1:10
					Лист	Листов	1
					ООО "НПО РИЗУР"		
					Формат А3		

Маркировочная таблица (позиционное обозначение прибора)	Разраб. Кудряшов	Пров.	Т.контр.	Н.контр. Агеев	Утв.
--	------------------	-------	----------	----------------	------

РизурБокс.3165